


Achtung: Dieser Messschieber ist nicht wasserdicht. Wenn sich Kühlflüssigkeit auf dem Aufkleber befindet, kann die Anzeige ungenau sein. Bitte reinigen Sie den Aufkleber mit einem trockenen Tuch. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, reinigen Sie den Aufkleber bitte mit WD40.

Auflösung: 0.01 mm
Genauigkeit: +0.03 mm

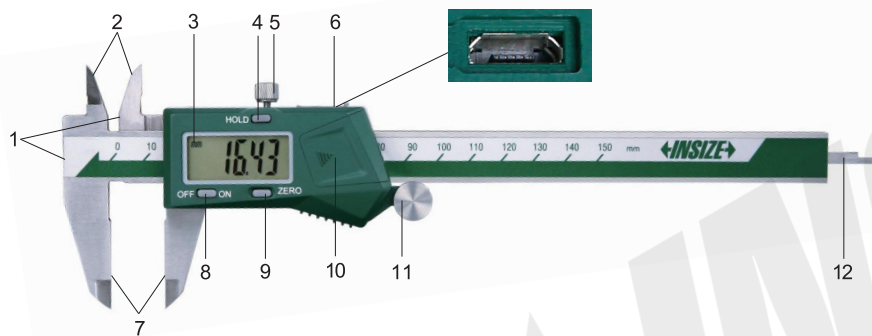

- 1-Stufen-Messflächen
- 2-Interne Messbacken
- 3-LCD-Display
- 4-"HOLD"-Taste
- 5-Feststellschraube
- 6-USB-Ausgang
- 7-Externe Messbacken
- 8-"OFF/ON"-Taste
- 9-"ZERO"-Taste
- 10-Batteriefachdeckel
- 11- Daumenrolle (nicht für Codes mit dem Suffix "W")
- 12-Tiefenmessleiste

1. Batterie einlegen:

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb. 1).
- Legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteriefach ein, wobei die positive Seite der Batterie (+) nach außen zeigen sollte (Abb. 2).
- Schließen Sie die Batterieabdeckung (Abb. 3).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

2. Tasten:

- "HOLD" dient zum Halten des Messwerts.
- "OFF/ON" dient zum Ein- und Ausschalten.
- "ZERO" dient zum Einstellen der Nullstelle.

3. Reinigen Sie die Messflächen mit einem weichen Tuch (Abb. 3), schließen Sie dann die Außenbacken und drücken Sie die Taste "ZERO", um die Nullstelle einzustellen. Der Messschieber sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Nullstelle korrekt eingestellt ist.

4. Um genaue Messungen zu erhalten, muss die Kraft kontrolliert werden. Üben Sie während der Messung immer eine konstante und angemessene Kraft auf den Messschieber aus. Die Messbacken sollten das Werkstück "festhalten" und dennoch auf dem Werkstück "gleiten" können.

5. Automatische Abschaltung nach etwa fünf Minuten. Drücken Sie die Taste "OFF/ON" oder bewegen Sie die digitale Einheit, um die Anzeige einzuschalten.

6. Optionales Zubehör: Datenausgangskabel (Code 7302-, 7315-, 7305-).

7. Eine Batterie reicht für ein Jahr. Wenn die Batterie leer wird, wird die Anzeige schwächer, es treten abnormale Messwerte oder andere Phänomene auf, wenn Sie die digitale Einheit bewegen. Bitte entfernen Sie die Batterie. Wenn der Messschieber länger als 3 Monate nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterie. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Messschieber beschädigen.

8. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie nach 1 Minute wieder ein.

9. Die Betriebstemperatur beträgt 0-40 °C/32-104 °C, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80 % nicht überschreiten.