


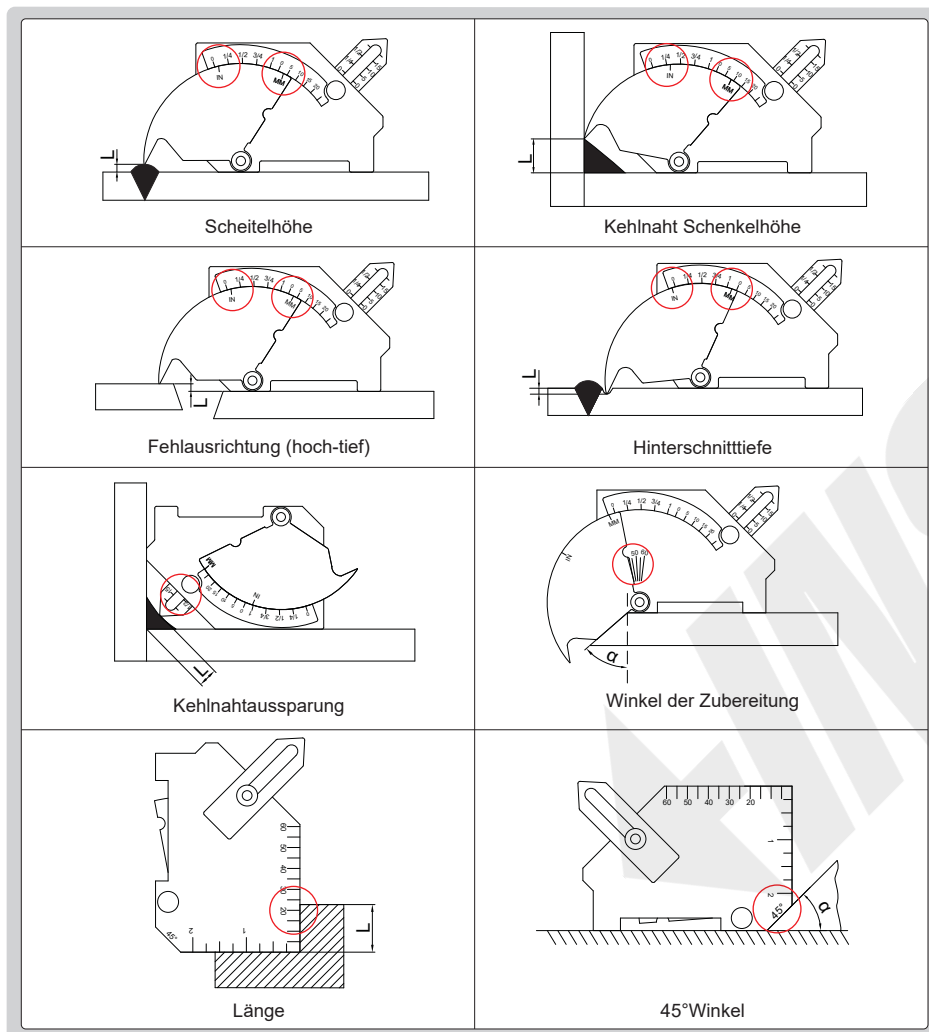

Messung	Bereich	Graduierung	Genauigkeit
Scheitelhöhe	0 - 25mm (0 - 1")	1mm (1/16")	±0.5mm
Höhe des Kehlnahtschenkels	0 - 25mm (0 - 1")	1mm (1/16")	±0.5mm
Versatz (hoch-tief)	0 - 25mm (0 - 1")	1mm (1/16")	±0.5mm
Tiefe des Hinterschnitts	0 - 2mm (0 - 1/8")	1mm (1/16")	±0.5mm
Größe der Kehlnahtaussparung	0 - 20mm (0 - 3/4")	1mm (1/16")	±0.5mm
Winkel der Vorbereitung	0 - 60°	5°	±1°
Länge	0 - 60mm (0-2")	1mm (1/16")	±0.5mm
45°-Winkel	—	—	±1°