




- 1-Vis de serrage
- 2-dispositif de préhension des mamelons
- 3-bras supérieur
- 4-interrupteur magnétique
- 5-Base magnétique
- 6-bras inférieur
- 7-Clés de serrage
- 8-vis sans tête

1. Ce support convient aux montres à levier. Il se fixe comme suit.

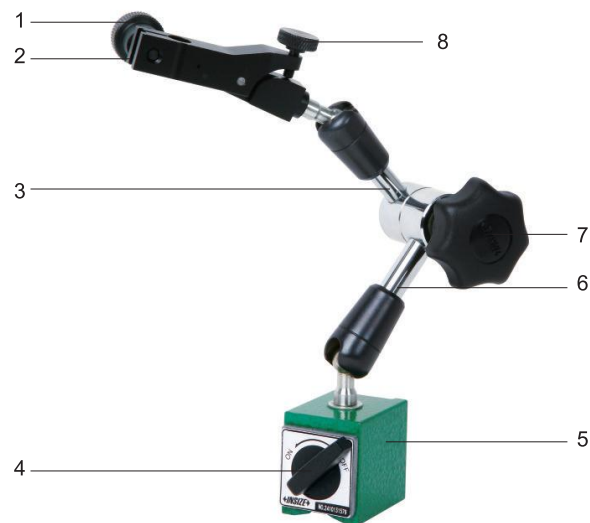

Queue d'aronde de serrage

2. Utilisation.

---Fixez la jauge de la manière indiquée ci-dessous.

Note : Pour éviter que l'élasticité du réglage fin n'affecte les résultats de la mesure, la vis de réglage fin doit être placée d'un côté différent de la sonde (Fig.1).

En cours de fonctionnement, régler la vis de réglage de manière à ce que la partie 1 se trouve entre le haut et le milieu des filets pour augmenter l'élasticité de la tête ; ne pas laisser la partie 1 se trouver en position basse des filets (Fig.2).




Fig.1

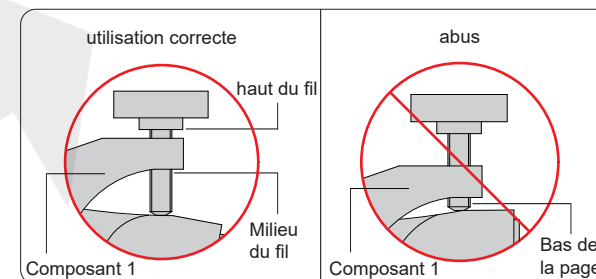


Fig.2

---Une fois que la base magnétique et la surface adsorbée sont complètement emboîtées, activez l'interrupteur magnétique pour vous assurer que le porte-montre est bien adsorbé sur la surface adsorbée.

Note : Veiller à ce que la base et la surface adsorbée soient propres afin d'éviter un léger glissement de la base pendant l'utilisation, ce qui pourrait affecter les résultats de la mesure.

---Desserrer la clé de blocage et la vis de blocage pour ajuster les bras supérieur et inférieur à la position souhaitée du gabarit du levier. Lorsque la table à levier est proche de la pièce, elle peut être ajustée en tournant la vis de réglage à l'aide du dispositif de réglage pour faciliter l'opération. Une fois le réglage terminé, assurez-vous que les pièces sont verrouillées de manière fiable.

---Lorsque la mesure est terminée, relâchez l'interrupteur magnétique pour retirer le support de la jauge magnétique de la surface d'aspiration.

3. Les vibrations peuvent entraîner des erreurs de mesure ; il convient donc d'éviter les vibrations lors de l'utilisation de l'instrument.